

Диагностика и лечение по Р. Фоллю. Вегетативный резонансный тест. Медицинские приборы «DETA»

Г.С. Галкин,

директор по развитию

НПК «МЕДСТАН»

ДИАГНОСТИКА

Каковы же особенности этого метода?

Быстрота - за один сеанс продолжительностью 1-1,5 часа проводится полное обследования организма по состоянию его биологически активных точек, расположенных на пальцах рук и ног. Для диагностики используются малые электрические токи (12,5 мкА), поэтому обследование превращается в приятную, безболезненную процедуру. Цель - нахождение и лечение первопричины болезни или предболезненного состояния, а не их внешних проявлений. Возможность определения болезни на ранней стадии, что способствует эффективности лечения. Метод позволяет установить глубокую обратную связь и отслеживать, что происходит в организме до лечения, во время и после лечения.

Строение кожи в местах расположения биологически активных точек имеет аномалию - там намного больше нервных окончаний. Все окончания ведут к спинному мозгу, точнее - к тем его сегментам, которые связаны с отдельными органами. А нервные импульсы представляют собой не что иное, как электрические разряды. Доктор Фолль начал измерять электрический потенциал кожи

людей. Именно в «волшебных» китайских точках он обнаружил отклонения от «нормы» - в них были совершенно иные значения потенциала. Официально считается, что первый прибор для измерения электрического потенциала кожи человека был сконструирован Фоллем совместно с инженером Вернером в 1953 году. Ученые проградуировали шкалу, отметив на ней сто условных единиц. Во время диагностики пациент должен держать в руке один из электродов прибора, другой электрод (щуп) врач прикладывает к определенным точкам. Если стрелка на шкале показывает 50-65 единиц, значит, точка и орган, связанный с ней, находится в энергетическом равновесии. Если же стрелка остановится на 70 или 100 единицах, это сигнализирует о воспалительных процессах. Бывает и такое, что прибор показывает меньше 50 единиц. Это означает, что орган «лишен сил» - нарушена его внутренняя структура, что-то мешает ему нормально функционировать. Вот так просто и верно можно диагностировать болезни и даже предпатологические нарушения. С помощью своего прибора немецкий врач открыл еще множество важных точек на коже человека, не описанных в восточной медицине, и провел через них

еще 8 меридианов. То есть в методике Фолля используется не 12, как в китайской акупунктуре, а 20 меридианов. Но в диагностике по Фоллю для удобства чаще используются точки рук (до запястья) и ног (до щиколотки). В 1956 году уже было создано целое медицинское общество, практиковавшее по методу Фолля, а в 1966 году метод получил Золотую медаль Ватикана.

ЛЕЧЕНИЕ

Раз так просто диагностировать, может, можно также легко и лечить, слегка усложнив прибор Фолля? Таким вопросом задался немецкий врач. Оказалось, что возможно и это. Так появилась электропунктурная терапия - воздействие на биологически активные точки не точечным массажем, не прогреванием полынной сигарой, а электричеством. Другими словами, Фолль добивался резонанса между искусственным источником колебаний и определенным органом (волновые характеристики всех частей человеческого тела были установлены соотечественником Фолля - Манфредом фон Арденом).

Кроме всего прочего, Р.Фолль сделал открытие, незамеченное должным образом современни-

ками. Он обнаружил, что терапевтическое воздействие электрическим током на точки акупунктуры зависит не столько от силы тока, сколько, в первую очередь, от частоты. Оказалось, что различные, иногда очень мало отличающиеся частоты, могут вызывать различные результаты при лечении. Фундаментальность этого открытия стала проявляться значительно позже.

В 1954 году Р.Фолль обнаружил, что у больного, коснувшегося рукой лекарства, изменились показатели электроакупунктурной диагностики. Эффект наблюдался даже тогда, когда непосредственного контакта с лекарством не было, а имел место зазор до пяти миллиметров. Стрелка возвращалась в нормальное положение, если больной просто брал в руку подходящее лекарство. Экспериментировал он преимущественно с гомеопатическими средствами. Обратите внимание - не принимал внутрь, а просто брал в руку! Это казалось, да и до сих пор кажется просто невероятным, но факт есть факт. Это явление можно объяснить тем, что лекарство, включаясь в электрическую цепь, передает информационный импульс в точку больного органа. То есть, используя метод Фолля, можно не только провести диагностику и электротерапию, но и индивидуально тестировать показания и противопоказания гомеопатического или любого химического препарата. Позднее Франц Морель и Эрих Раше установили, что лекарственные препараты обладают собственными электромагнитными колебаниями и эффект воздействия

лекарственных препаратов на расстоянии объясняется наличием у них набора гармонических колебаний в диапазоне от единиц до миллионов герц. Они установили также, что в организме человека существуют электромагнитные колебания сравнимого вида и порядка величины, ослабляемые или усиливаемые колебаниями лекарственного препарата. Используя метод Фолля, можно индивидуально назначить пациенту не только необходимое лечение, но и подобрать подходящие для конкретного человека благородные камни, минералы, неизбежно так или иначе воздействующие на организм. Можно также подобрать косметику, одежду, украшения. Что это доказывает? Поверьте о том, что определенные камни и металлы благоприятны и неблагоприятны для человека - не вымысел. Их влияние проверяется на меридиане аллергии. Кстати, абсолютно для всех людей освященные нательные кресты (неважно из какого материала они сделаны) оказывают положительное, гармонизирующее влияние. Если освященный предмет положить на руку и тестировать контрольную точку с меридиана аллергии, то прибор мгновенно реагирует. Стрелка прибора выравнивается ровно на 50 единицах - норма. Диагностику рекомендуется проводить при естественном излучении, при снятых кольцах, на лице женщин не должно быть косметики, обязательно отсутствие маникюра (видимо, это каким-то образом влияет на показания прибора). В практике врача-фоллиста не раз приходится сталкиваться с тем, что снятие традиционно носимого

кольца (даже обручального) позволяет, наконец, забеременеть или впервые заснуть крепким сном, забыть про хроническую головную боль. Кольца, надетые на определенные пальцы, постоянно воздействуют на биологически активные точки. Прибором Фолля можно измерить совместимость кольца с человеческим организмом, понять причину длительного дискомфорта. Эффективность диагностики и лечения по этому методу достигает 80-85 процентов. С трудом поддаются этому методу диагностики онкологические заболевания, а также психиатрические, которые не лечатся на физическом уровне. В то время на этот факт не обратили должного внимания. А в наше время уже общезвестна роль этих процессов при проведении медикаментозного тестирования, применяемого в электропунктуре. По методу доктора Р. Фолля (ЭАФ) вместо игл применяется латунный точечный электрод (активный электрод) и электрод цилиндрической формы, диаметром около 2,5 см (пассивный электрод), который пациент держит в руке. Положительным фактором такой диагностики является единая система оценки результатов измерений электропроводности (ЭП) для всех органов, тканей и взаимосвязанных с ними акупунктурных точек. Бурному развитию этого метода предшествовал большой период экспериментальных исследований, направленных на поиск статистически значимых взаимосвязей между величинами ЭП отдельных биологически активных точек (БАТ) у пациентов с заранее известной формой патологии, ее стадией и обнаружива-



емыми в соответствующих органах, тканях морфофункциональными изменениями.

Диагностические приборы «DETA»

Научно-производственным предприятием «ЭЛИС» разработан целый ряд медицинских приборов «DETA» для диагностики по методу Р.Фолля, которые в настоящее время реализуются НПК «МЕДСТАН». Оба предприятия являются звеньями единой инфраструктуры.

Диагностический прибор «DETA-D» выпускается в четырёх модификациях:

1. Самый простой прибор для диагностики по методу Р.Фолля «DETA-D». Предназначен для диагностики, индивидуального подбора медикаментов, лекарственных трав, украшений и косметики. Прибор популярен у врачей стоматологов для индивидуального подбора стоматологических материалов. Также прибор покупают для индивидуального подбора частот в электромагнитной терапии.



2. «DETA-D» со встроенным репринтером для энергоинформационного переноса свойств медикаментов. Прибор позволяет проводить диагностику по методу Р.Фолля, индивидуально подби-

рать медикаменты, лекарственные травы, украшения и косметику.



Работая с медикаментозным селектором, можно не только подбирать гомеопатические средства, но и готовить электронные копии.


3. «DETA-D» со встроенным устройством для вегетативного резонансного теста «VEGA-Test».



В прибор встроен репринтер для энергоинформационного переноса свойств медикаментов. Благодаря расширенным диагностическим возможностям, с помощью этого прибора можно проводить диагностику по методам Р.Фолля и Х.Шиммеля.

4. «DETA-D» со встроенным устройством для вегетативного резонансного теста «VEGA-TEST». В прибор встроен активный репринтер для энергоинформационного переноса свойств медикаментов с усилением, в прямом и инверсном виде. С помощью этого прибора можно готовить аутонозоды

для лечения. Из диагностических приборов эта модель обладает самыми широкими возможностями. Приборы «DETA-D» могут работать с программой и комплектуется удобным щупом, ручными электродами и необходимыми аксессуарами для работы.

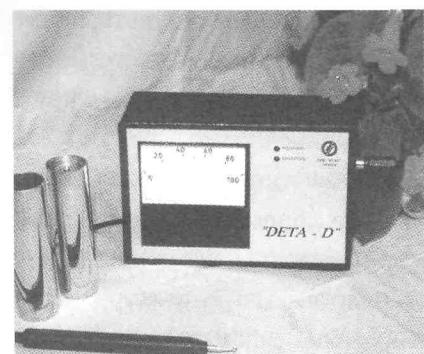

ВЕГЕТАТИВНЫЙ РЕЗОНАНСНЫЙ ТЕСТ

Вегетативный резонансный тест (ВРТ) был разработан в Германии Х. Шиммелем в 1978 году. Безусловно, он более прост в процессе диагностики и в то же время более информативен по сравнению с методом электропунктурной диагностики по методу Р.Фолля. В методе ВРТ используется 1-2 биологически активные точки (БАТ), а в методе электропунктурной диагностике по методу Р.Фолля их используется от 300 до 1160 таких точек.

Особое место в ВРТ занимает тестирование бактериальных, мицетических и вирусных заболеваний, а также их последствий, отягоченные тяжёлыми металлами и экотоксинами, наследственная врождённая токсическая информация (миазмы по С. Ганеману). С помощью этого метода распознаётся порядка 250-300 грибков и вирусов, идентифицируются бактерии и глистные инвазии, оценивается состояние

центральной нервной системы, выявляются эндокринные нарушения. Можно определить, каких витаминов или микроэлементов не хватает в организме, а каких - избыток. При помощи ВРТ тестируются такие болезни (а, главное, причины их возникновения) как онкологические заболевания, рассеянный склероз, бронхиальная астма, различные виды аллергий, диабет и другие заболевания. Таким образом, ещё до клинических проявлений можно обнаружить опухоли и возможно говорить о вероятности их образования. Стоит добавить, что такая диагностика абсолютно безболезненна, что немаловажно при работе с детьми. Тестирование пациента осуществляется с помощью приборов «DETA» со встроенным устройством для вегетативного резонансного теста «VEGA-Test». Благодаря расширенным диагностическим возможностям, с помощью этих приборов можно проводить диагностику по методам Р.Фолля и Х.Шиммеля. В некоторые из приборов встроен активный репринтер для энергоинформационного переноса свойств медикаментов с усилением в прямом и инверском виде. С его помощью можно готовить аутонозы для лечения. Во время проведения диагностики по методу ВРТ не наблюдается никаких нарушений кожного покрова, никаких неудобств для больного.

В ходе диагностики четко видно, какой орган «не дотягивает» до нормы или воспален, дает сбой, и почему это происходит. Обследование проводится как от-

дельных органов, так и всего организма, что равнозначно диспансеризации по 25-30 врачебным специальностям. Выявляются изменения в организме, вызванные токсическими, лучевыми и другими различными неблагоприятными факторами.

Преимуществом является то, что могут обследоваться пациенты любого возраста, начиная с грудного, а также находящиеся без сознания, глухонемые. Методы диагностики помогают разрешить тонкие этические проблемы, например, связанные с обследованием женщин востока.

Диагностический потенциал метода огромен - а как быть с лечением?


На этапе терапии используются различные методики биорезонансной (метод классической биорезонансной терапии представлен в приборе «DETA-BRT»), мультирезонансной, электропунктурной (о которой я упоминал выше), полевой терапии. Для врачей незаменимыми являются медицинские приборы, позволяющие проводить диагностику, а главное - комплексную терапию, например «DETA-




UDT», «DETA-Professional».

«КОПИРОВАНИЕ» МЕДИКАМЕНТОВ

Осталось коснуться еще одного необъяснимого открытия немецкого врача - это «перенос» или «копирование» информации с медикаментов на таблетки-пустышки. Перенос (энергоперенос) найден и доказан был Ф.Мореллем в 1978 году. Было взято техническое устройство, представляющее собой в простейшем виде электрический проводник, к нему присоединили две контактные ячейки для тестирования медикаментов. В одну ячейку, которая помещалась внутри колебательного контура, врач положил гомеопатический препарат, в другую - шарики-пустышки. При подключении этого устройства к регулируемому

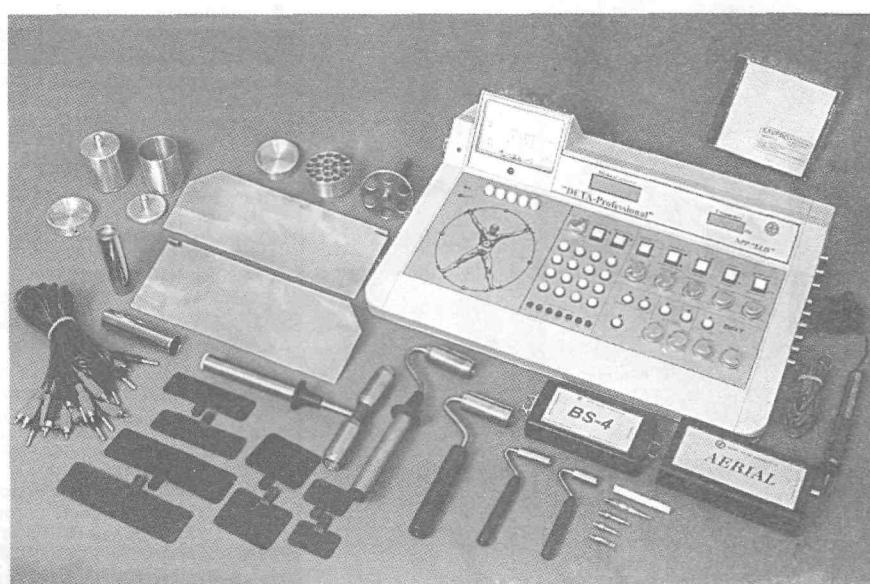

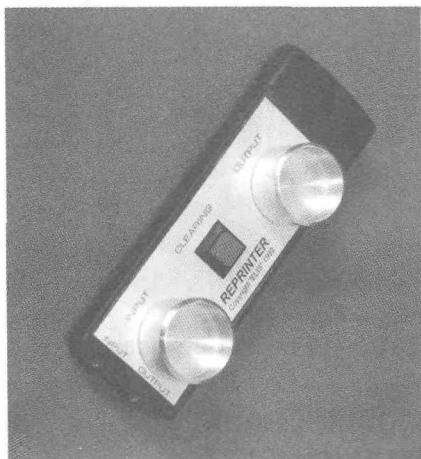

источнику постоянного тока по металлическому проводнику свойства медикамента передавались пустышке. Оказалось, что переносить таким образом свойства медикаментов (в частности, очень дорогостоящих) можно и на дистиллированную воду или спирт. Как показала практика, полученные лекарства помогают больным даже несколько эффективнее, чем «оригиналы». Механизм этого явления также до сих пор не изучен, неизвестна и физическая природа переноса свойств одного вещества на другое. В настоящее время эффект активно изучается, и исследовате-

ли для его обозначения используют самые разные термины - биоинформационный перенос, импринтинг, перезапись информации. Большинство выдвинутых гипотез предполагает обязательное наличие полевого (электромагнитного, магнитного, акустического) компонента, как необходимого элемента для переноса информации. оказывается, можно не только переносить свойства медикаментов на гомеопатическую крупку, воду и растворы, но и усиливать их воздействие в десятки раз.

Приборы, позволяющие осуществлять информационный перенос, представлены двумя отдельными приборами: пассивный и активный репринтеры. Активный репринтер отличается от пассивного

возможностью увеличения «силы» действия препарата и приготовления инверсии (препарата обратного действия).

А теперь, внимание! Ключевой новостью стала разработка и серийное производство четырёх типов портативных приборов «DETA» (7 программ): «Красота Ваших ног» (Как победить варикозное расширение вен); «Ясные глаза» (Как победить проблемы со зрением. Программы от глазных заболеваний); Стройная фигура» (Как победить избыточный вес. Программы от ожирения); «Детоксикация организма» (Как победить заболевания при помощи глубокой очистки организма). Любой желающий может приобрести эти приборы.



**НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ
«МЕДСТАН»**
Россия, 127006, г.Москва, а/я 49
[http://medstandeta.narod.ru;](http://medstandeta.narod.ru) [www.medstan.ru;](http://www.medstan.ru) medstan@rambler.ru

ПРОИЗВОДИТ И РЕАЛИЗУЕТ

широкий спектр медицинских приборов серии
“DETA” профессионального и индивидуального
назначения:

◆ электроакупунктурной диагностики, терапии и индивидуального подбора медикаментов по методу Р.Фолля;
◆ биорезонансной терапии; ◆ квантовой терапии;
◆ полевой терапии;

ДИЛЕРЫ:

г. Владивосток, Щеглова Ирина Константиновна, к.м.н,
координатор. Тел./факс: 25-67-28.
г. Владикавказ. Дюева Наталья Геннадьевна. Тел.: (8672) 51-74-70
г. Воронеж, Барсуков Максим Владимирович,
Тел.: (0732) 50-23-19 моб. 8-903-651-01-67
г. Екатеринбург, ООО "Б. Мухини Мурти",
Тел. (3432) 74-43-07, 49-44-11
г. Ижевск, ЧП "Коротков", Тел. (3412) 47-71-80
г. Киров, ООО "Вятмедсервис", Тел. (8332) 69-32-43
г. Оренбург, ООО "ЛОГОС", Тел. (3532) 52-96-01, 52-92-78
г. Рязань, ООО "Спрай", Тел. (0912) 96-21-21

ПРЕДЛАГАЕТ ПО ЦЕНАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ:

электротерапевтические аппараты серии “ПРОЛОГ”;
электромассажёр “СПАРКИ” (токи Д’Арсонвала);
аппарат для магнитной терапии “МАГНИТЕР”;
вертебральный массажёр “СВИНГ МАШИНА”

Курсы повышения квалификации по методам:

- Р.Фолля;
- Вегетативного Резонансного Теста (Х.Шиммель);
- Биорезонансной терапии (Ф.Моррель и Э.Раше);
- Риодораку (В.Накатани)

Тел.: (095) 299-70-26, 299-08-75, 299-45-61